

PRÜFMITTEL

- Im Prüfmittelverzeichnis werden alle Prüfmittel wie Micrometer, Grenzlehrdorne usw. erfasst.
- Eine Liste zeigt welche Prüfmittel zur Kontrolle fällig sind.
- Daten können für andere Anwendungen exportiert werden.

Prüfmittel (Muster AG)


Suchbegriff:

ID	Inventar-Nr.	Bezeichnung	Messbereich	LetztePrüfung	NächstePrüfung
1	P.013.0090	Messschieber Etalon	250 (Keusen)	11.11.2014	11.11.2015
2	102	Gew. Grenzlehrdorn DC	M5	11.11.2009	11.05.2010
3	50	Tiefenmessschraube PAV	25	11.11.2009	11.11.2011
4	6	Grenzlehrdorn	12 H7	11.11.2009	11.11.2010
5	16921	3-Pt-Innenmessschr. Micro	90-140	30.12.2002	30.12.2009
6	56	Messschieber Mitutoyo	150	14.01.2002	14.01.2008
7	55	Tiefenmessschieber Etalon	300	06.02.2002	06.02.2007
8	206	Messschieber Etalon	150	26.01.2007	26.01.2012
9	51	Messschieber PAV	150	11.11.2009	11.11.2011
10	209	Bügelmessschraube Tesa	D-25	11.11.2009	11.11.2010
11	5064	3-Pt-Innenmessschr. Micro	90-140	11.11.2009	11.11.2012
12	7295	3-Pt-Innenmessschr. Micro	140-240	11.11.2009	11.11.2013
13	7996	3-Pt-Innenmessschr. Micro	60-90	05.05.2002	05.05.2008

Ausgelagerte Prüfmittel

ID	Nr	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Bezug
2	102	Gew. Grenzlehrdorn DC	M5	04.11.2012
9	51	Messschieber PAV	150	15.10.2013
15	59	Messschieber Etalon	150	01.03.2021
13	7996	3-Pt-Innenmessschr. Micr...	60-90	22.03.2016

STAMMDATEN

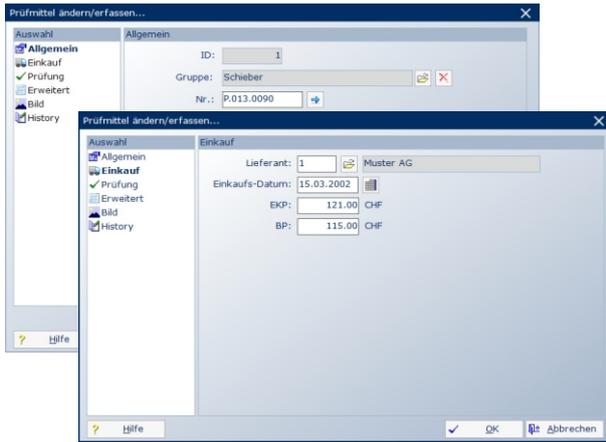


Mess- und Prüfmittel müssen regelmässig kontrolliert und gewartet werden.

Wann und wie legen Sie fest.

Durch den hinterlegten Lagerort werden diese im Bedarfsfall schnell gefunden.


PRÜFANWEISUNGEN

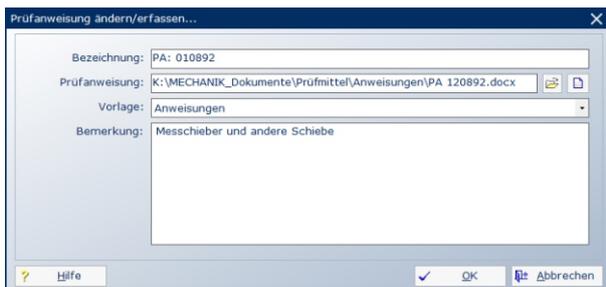

Mit den Prüfanweisungen (z.B. Word-Dokument) wissen Ihre Mitarbeiter, was zu tun ist.

Die Prüfpläne werden den Prüfmitteln zugewiesen.

EIN-/AUSLAGERN

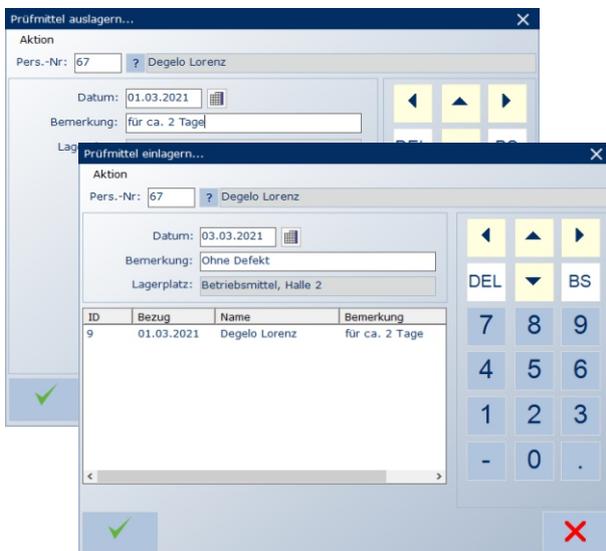

Prüfmittel werden ein- und ausgelagert. Eine Übersicht zeigt welche Prüfmittel von Mitarbeitern zurzeit verwendet werden.